
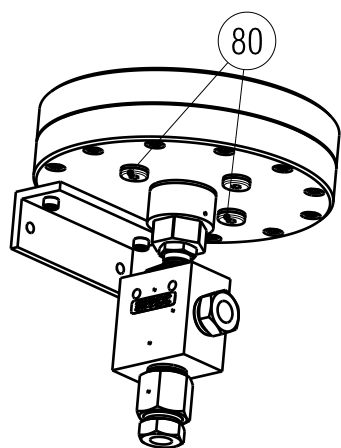


15 Kontrollmass bei Ventil geschlossen

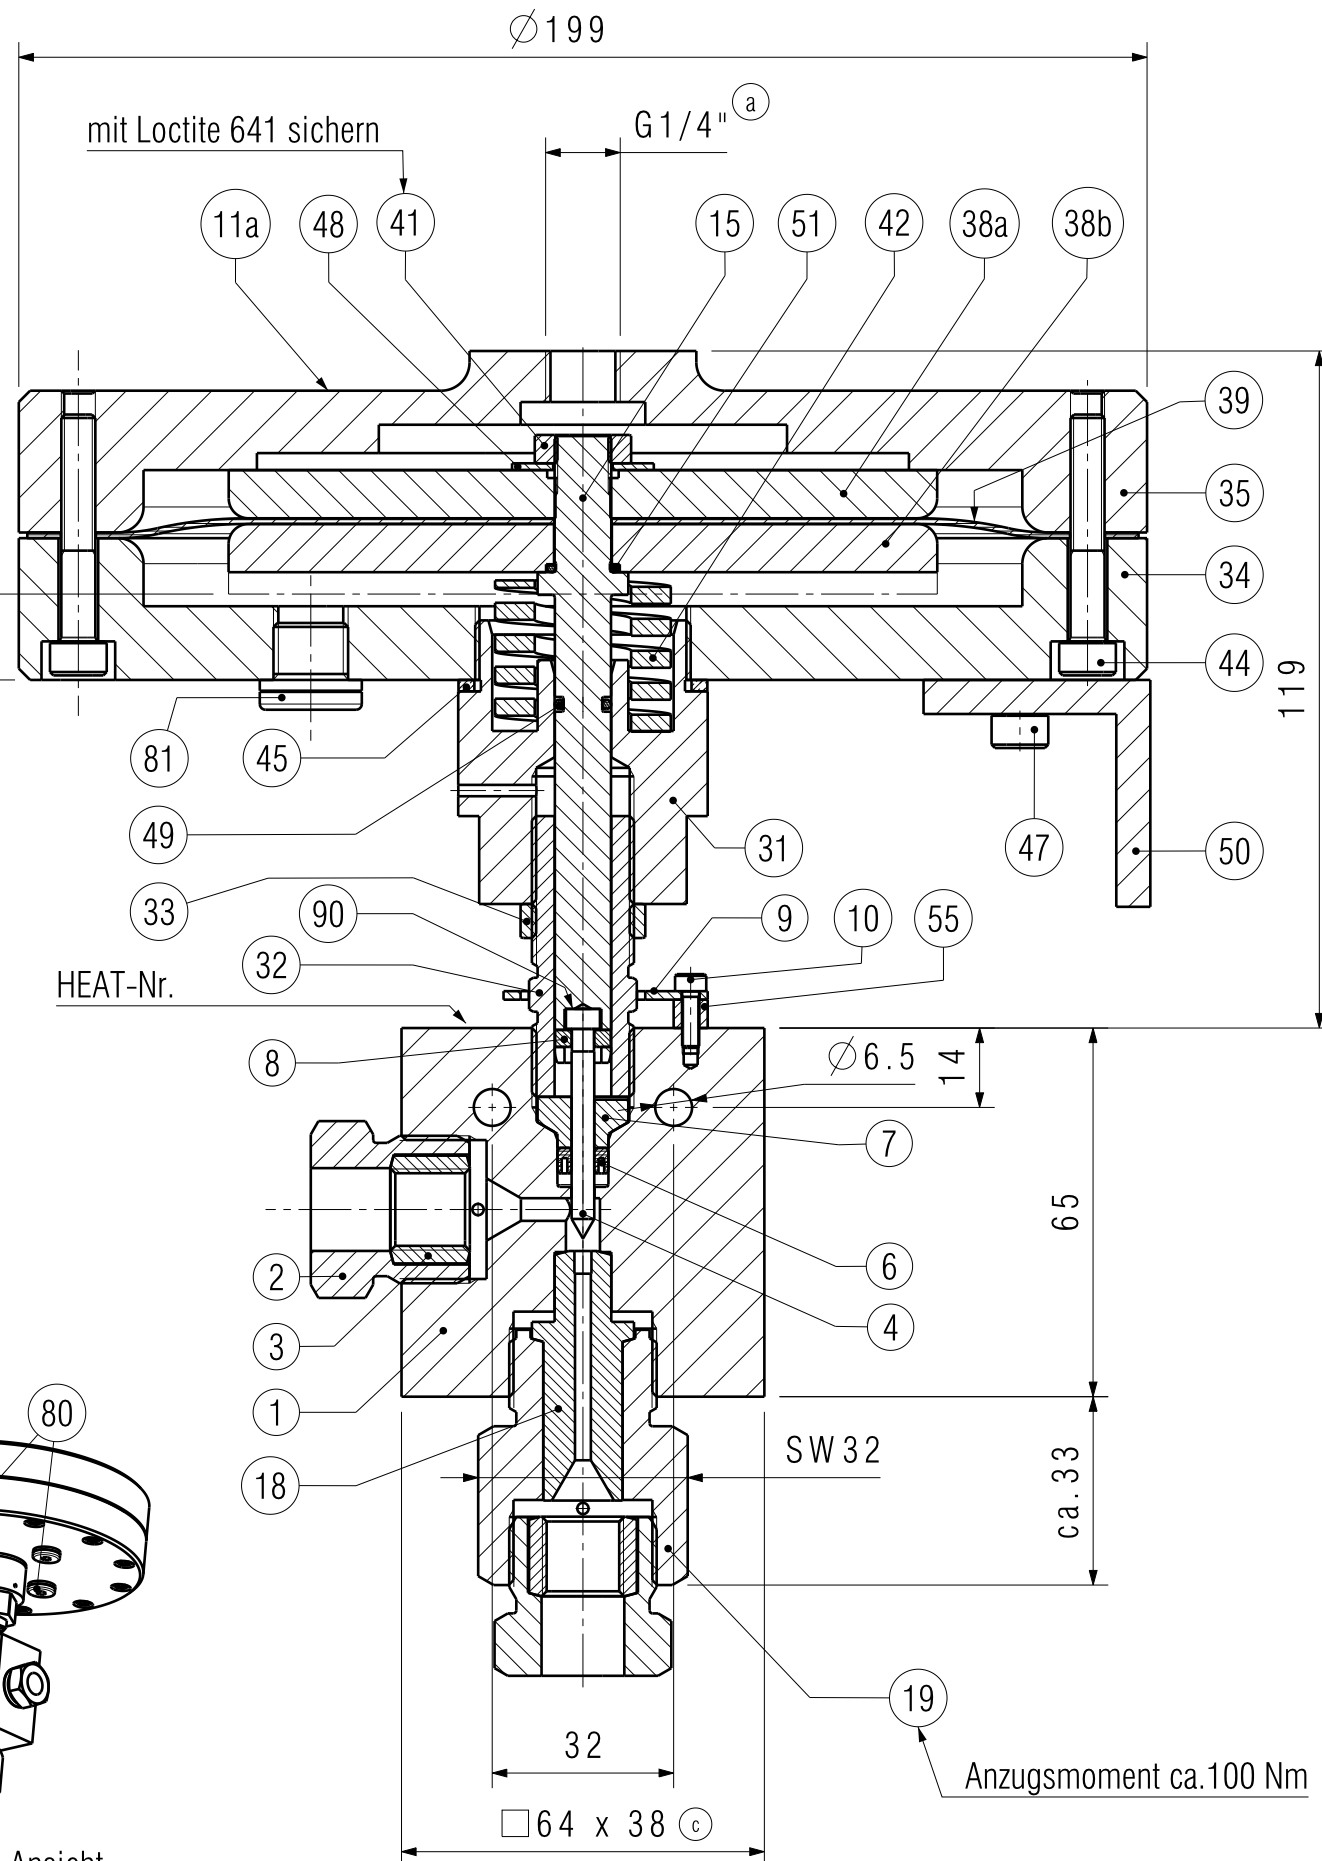

Isometrische Ansicht
Maßstab: 1:5

Beschriftung:
SITEC
710.5163-1-LD
4000bar-9/16HP-DN3-NO
AISI 316Ti - 1.4571

1	Körper	711.0146-6-2	(c)	1	1.4571
2	Druckschraube 9/16 HP	720.0110		2	
2	Druckring 9/16 HP	720.0120		3	
1	1 Spindel ø4	711.0303-2-22	(b)	4	1.4112 (beschichtet)
1	1 Lippendichtung Ø9 x ø4 x 4,5	791.59.0011-E		6	PUR
1	1 Druckstück	711.0412-5	(c)	7	
1	1 Paar Segment	711.1317		8	
1	1 Sicherungsblech	711.0774		9	
1	1 Zyl-Schr In-6kt M3 x 10	791.04.0011-2		10	
2	2 Firmenschild	711.0255		11	
1	1 Schild "Steuer-Druckluft 6 bar NO"	791.90.0001-6		11a	
1	1 Antriebsspindel	711.0314-1		15	
1	1 Wechselsitz	711.0227-1		18	1.4542
1	1 Wechselsitzschraube	711.0231		19	
1	1 Zylinder-Verlängerung	711.0710-2		31	
1	1 Verbinder	711.0730-1		32	
1	1 Mutter	711.0731		33	
1	1 Flansch unten	711.0711		34	
1	1 Flansch oben	711.0713		35	
1	1 Scheibe	711.0714-NO		38a	
1	1 Scheibe	711.0714-NO-St		38b	
1	1 Membrane	711.0213		39	EFFBE
1	1 Mutter	711.0705		41	
1	1 Druckfeder ø31 x (7x3) x ø38	791.01.0057-1		42	
10	10 Zyl-Schr In-6kt M6 x 40	791.05.0004-4		44	
1	1 Dichtring ø38 x ø44 x 2	791.26.0001-3		45	
2	2 Zyl-Schr In-6kt M6 x 45	791.05.0001-4		47	
1	1 U-Scheibe ø10,5 x ø25 x 1,2	791.28.0032-6		48	
1	1 O-Ring ø6 x 2	791.39.0004-1		49	NBR
1	1 Befestigungswinkel	711.0718		50	
1	1 O-Ring ø9,25 x 1,78	791.39.0014-1		51	NBR
1	1 Distanzhülse	791.99.0061		55	
2	2 Blindstopfen	791.99.0389	(a)	80	
1	1 Entlüftungsstopfen	791.99.0389-1	(a)	81	
Spielbeseitigung durch Einsetzen von:				90	
Distanzscheibe		791.80.0004-1			
Distanzscheibe		791.80.0005-1			
Distanzscheibe		791.80.0006-1			

Ersatzteile				
Anzahl	Gegenstand	Sitec-Nr.	Pos.	Material

Alle Rechte an dieser Zeichnung bleiben bei uns. Weitergabe an Dritte oder Vervielfältigung ohne unsere Genehmigung ist unzulässig. This drawing remains our property. Passing on to third parties or reproductions are only permitted with our consent. Tous droits réservés à ce dessin nous sont réservés. Il est interdit de le remettre à des tiers ou de le reproduire sans notre consentement.	Druck [bar]	4000	gehört zu	-	Änd.	a	06.04.2011 JS				
	Temperatur [°C]	*100	Spezielles			b	22.07.11 FR				
	Volumen [ml]	-	*max. Mediumstemperatur	Ⓢ		c	07.03.14 FR				
	DN [mm]	3				Gezeichnet	25.09.2008 S.Keller				
	Anschlüsse	9/16 HP				Geprüft	24.03.14 S.Keller				
				Benennung	Massstab					Anzahl Blatt	Blatt - Nr.
Sieber - Engineering AG Aschbach 7 CH-8124 Maur / Zurich Switzerland			Ventil pneum. Typ 6 mit Membranantrieb NO	1:1		1		1		A3	
				Zeichnungsnummer						Anderungsindex	
				710.5163-1-LD						c	