


Informationsblatt zum Röhrenwechsel

Röhrenwechselintervall der sterilAir® UVC-Röhren

- Nach 12000 Betriebsstunden bzw. 16 Monaten muss ein Röhrenwechsel stattfinden.

Die Betriebssicherheit der UVC-Anlage wird gewährleistet.

Der Garantieanspruch auf die sterilAir® UVC-Röhren und die UVC-Anlage bleibt erhalten.

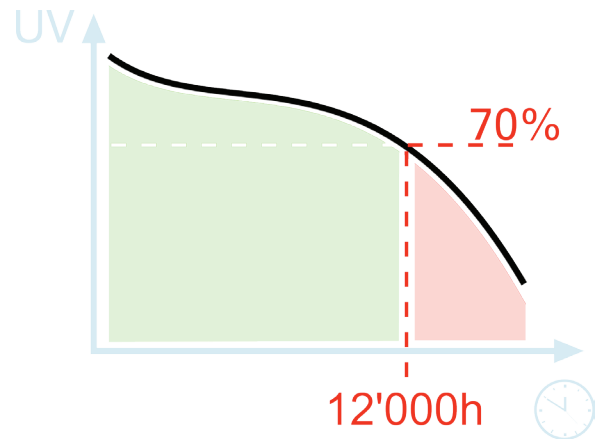


Röhrenwechsel nur mit Original sterilAir® UVC-Röhren

- sterilAir® UVC-Röhren und sterilAir® Hoch-Frequenz-Elektroniken bilden eine System-Einheit. Nur in dieser Kombination wird höchste Sicherheit und Entkeimungsleistung garantiert.

sterilAir® UVC-Röhren sind nur Original mit sterilAir® Schriftzug.

Es sind ausschliesslich Original sterilAir® Dichtungsringe und sterilAir® Ersatzteile zu verwenden.

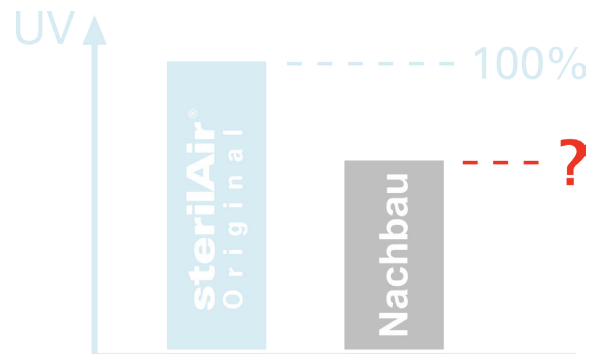

Entsorgung der sterilAir® UVC-Röhren

- Eine fachgerechte Entsorgung der sterilAir® UVC-Röhren wird gewährleistet.

Rücksendung der Röhren an folgende Adresse:

sterilAir GmbH
August-Borsig-Strasse 13
D-78467 Konstanz

